

白癬菌検出用試薬

ズーム[®]


容器・個装ケース・包装箱の
表示内容変更と個装ケース・
包装箱のサイズ変更のご案内

容器



※診断用医薬品（劇薬）から医薬用外劇物への変更に伴い、表示を変更します。
※医薬用外劇物への変更に伴い製造者を表示します。（個装ケース、包装箱も同様の変更となります）

個装ケース

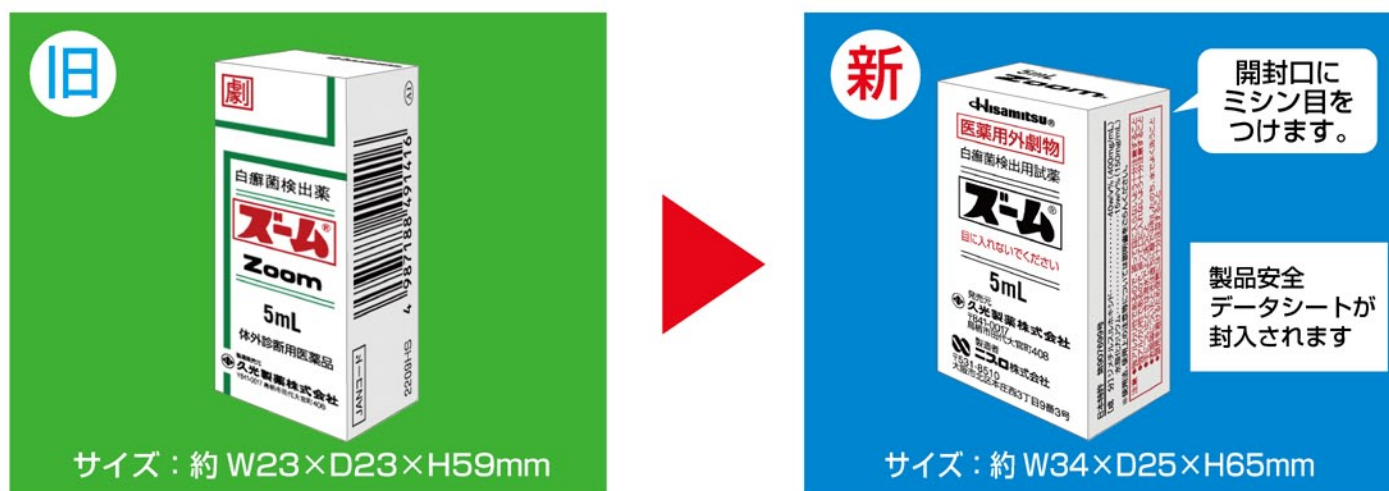

※JANコードが「4987188491416」から「4987188491430」へ変更します。
※側面注意書き部分の「内服用等に使用しないこと」を「強アルカリ性であるので、誤って口に入れられないよう十分注意すること」へ変更します。
※「白癬菌検出薬」を「白癬菌検出用試薬」へ変更します。
※RSS-14 Stackedコードを削除します。

謹啓
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当社商品に格別のご高配を頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、この度白癬菌検出用試薬「ズーム」の容器・個装ケース・包装箱のサイズおよび表示の一部を変更致しますので下記の通りご案内申し上げます。
今後ともなお一層のご愛顧を頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白
久光製薬株式会社

包装箱



※ITFコードを「14987188491413」から「14987188491437」へ変更します。
※GS1-128コードを削除します。
※「水酸化カリウム 15%含有」を表示します。

変更品製造番号と出荷予定時期

変更品製造番号	当社出荷予定時期
00106	7月中旬

出荷時期は、在庫の状況により前後することがございます。
変更の際しまして、流通段階の在庫の関係で現行商品と変更商品が混在する場合がございます。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。